

省际联盟输液器等4类医用耗材带
量价格联动采购工作
企业申报

操作说明

二零二四年九月

一、登录流程

1、申报企业进入网址：点击“带量采购报名子系统”

<https://ggfw.ybj.ln.gov.cn/tps-web/indexHome>



图 1.1 初始界面

2、点击“企业登录”，首次登录点击“注册”进入注册界面。不支持 IE8 内核以下浏览器，如遇显示问题，请在浏览器“兼容模式”和“极速模式”之间切换，或更换浏览器。



图 1.2 登录界面

3、填写并上传企业基本信息，完成后点击“注册”，请牢记企业账号和密码，注册成功后等待审核，审核时间 1 小时左右，等待期间请勿重复注册。同时申请进入项目咨询 QQ 群 681194607，每个企业只能有一人申请进入。

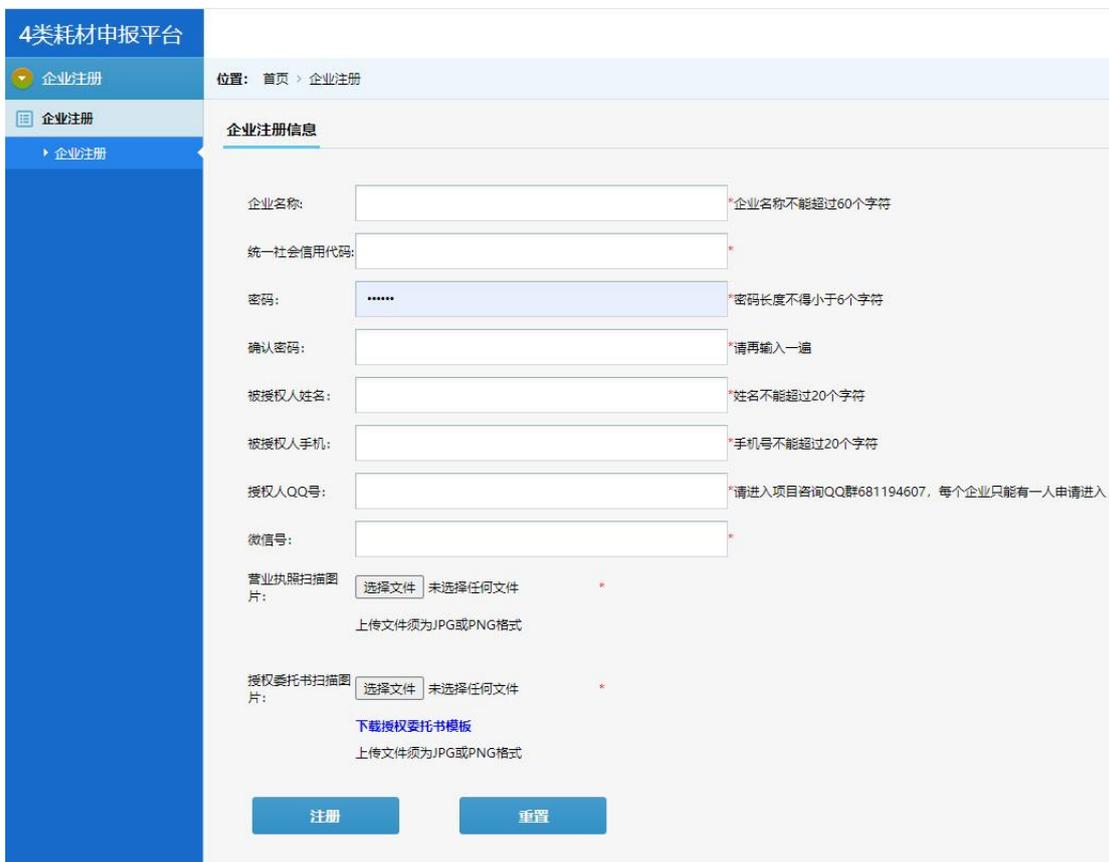


图 1.3.1 注册界面



图 1.3.2 注册后界面

4、再次进入登录界面输入用户名和密码进行登录。如未通过审核，再次登录时会提示未通过的原因，需按要求修改企业信息。



图 1.4.1 登录界面



图 1.4.2 审核不通过界面

二、企业信息填报

1、登录成功，首页可以下载“通知文件”和“操作说明”，请仔细阅读。



图 2.1 登录首页界面

2、点击左侧“企业信息申报-企业信息”，进入企业基本信息申报页面，使用模板填写后打印盖章扫描成 JPG 或者 PNG 格式上传，点击“选择文件”选中文件，点击“上传”，文件能显示出来即为上传成功。

（模板如为两页，需分页上传）所有信息上传完毕后点“提交审核”，完成企业信息填报工作。“提交审核”后不必等待审核结果，直接进

入“产品申报-产品信息”界面进行产品申报工作。

企业资质信息

省际联盟输液器等4类医用耗材带量价格联动采购项目承诺函：

第一张：* 未选择任何文件 [模版](#) 上传文件须为JPG或者PNG格式

第二张：* 未选择任何文件 上传文件须为JPG或者PNG格式

器械生产/经营许可证扫描图片：

第一张：* 未选择任何文件 [模版](#) 上传文件须为JPG或者PNG格式

医药企业价格和营销行为信用承诺书

第一张：* 未选择任何文件 [模版](#) 上传文件须为JPG或者PNG格式

第二张：* 未选择任何文件 上传文件须为JPG或者PNG格式

图 2.2.1 企业信息申报界面

4类耗材申报平台

首页

企业信息申报

企业信息

申报产品

提交审核

企业信息

企业基本信息

企业名称：* 输液器测试

统一社会信用代码： 91321000000000007H

执照副本扫描图片：

授权委托书扫描图片：

图 2.2.2 提交审核界面



图 2. 2. 3 提交审核成功界面

注意：需先提交“企业信息”后才能进入“产品申报”界面。否则会有以下提示。



图 2. 2. 4 企业信息未提交提示界面

三、产品申报

1、点击“申报产品-产品申报”，点击“添加耗材申报信息”按钮，进行产品申报工作。



图 3. 1 产品申报界面

2、进入“选择产品”界面，在搜索栏输入完整的国家医保平台 27 位

医保编码进行查找，点击“搜索”按钮搜索，下方出现查找到的产品
 点击“选择”按钮选中产品，进入“添加产品信息界面”。



图 3.2.1 搜索产品界面



图 3.2.2 选择产品界面

注意：如下方界面直接显示的“基础目录”产品原则上需申报。



图 3.2.3 基础目录产品界面

3、根据通知文件要求填写申报产品信息，包括标的组、品牌、产品描述、价格信息、截图等。完成后点击“保存”，循环之前的操作进行下一条产品申报，直至全部填报完成。**注：11-15 组需填写人份数；16-18 组需填写 ml 数。**

添加产品信息

医保编码 C [模糊] 规格 [模糊] 型号 [模糊] 标的组* 10瓶立式导管冲洗器、3ml、5ml、10ml 产品描述* 请选择 2022年4月至今联盟地区原带量采购中选价格* 原带量采购中选价格 联盟地区最低实际采购价格* 联盟地区最低实际采购价格 国家医保平台27位医保编码截图 [选择文件] 未选择任何文件 上传文件须为JPG或者PNG图片

①请正确选择标的组，因选择标的组错误造成的后果由申报企业自行承担。
②价格填写以“元”为单位，保留小数点后两位，没有价格填“无”。

单件产品名称 预充式导管冲洗器 生产厂家 [模糊] 注册证号 [模糊] 品牌* 品牌 是否为2022年4月至今联盟地区原带量采购中选产品* [模糊]

标的组* 14血液透析B粉 (需满足使用4.5小时) 品牌* 品牌 人份数* 人份数/m数 2022年4月至今联盟地区原带量采购中选价格* 原带量采购中选价格

图 3.3 添加产品信息界面

注意：国家医保平台 27 位医保编码截图举例：

地址：<https://code.nhsa.gov.cn/toSearch.html?sysflag=1004>

国家医保信息业务编码标准数据库动态维护

分类目录 医用耗材信息

注册证号

注册证名称: [模糊] 单件产品名称: [模糊] 规格: [模糊]

注册证号: [模糊]

注册证号	注册产品名称	医保耗材分类编码	注册人	单件产品名称	企业名称	规格	型号
1	国械注准20153142101 一次性使用输液器 带针	[模糊]	[模糊]	[模糊]	[模糊]	[模糊]	[模糊]
2	国械注准20153142102 一次性使用输液器 带针	[模糊]	[模糊]	[模糊]	[模糊]	[模糊]	[模糊]
3	[模糊]	C142301202000	[模糊]	[模糊]	[模糊]	[模糊]	[模糊]
4	[模糊]	[模糊]	[模糊]	[模糊]	[模糊]	[模糊]	[模糊]

4、产品申报成功后如有需要，可点击“删除”按钮后重新申报该产品。

4类耗材申报平台

首页 > 申报产品 > 产品申报

国家医保平台 27位医保编码截图

请申报企业详细阅读《关于当前联盟输液器等4类医用耗材带量价格联动采购工作的通知》和《操作手册》，按文件要求在规定的时间内完成产品申报工作。

流水号	国家医保编码	标的组	产品描述	单件产品名称	品牌	规格	型号	生产企业	注册证号/备案号	2022年4月至今联盟地区原带量采购中选产品	最低	最高	2022年4月至今联盟地区最低实际采购价格	联盟地区最低27位医保编码截图	申报价格	操作
2304	[模糊]	[模糊]	[模糊]	[模糊]	[模糊]	[模糊]	[模糊]	[模糊]	[模糊]	[模糊]	[模糊]	[模糊]	[模糊]	[模糊]	0.20	删除

图 3.4 删除产品界面

5、添加完所有产品后，点击“申报”按钮，按照要求进行申报价格，填写完价格后点击保存。如需对申报价格进行修改可再次点击

价格进行修改。



图 3.5 产品申报价格界面

注意（1）：申报企业按要求填报产品信息，填报产品规格型号原则上应尽可能覆盖并满足临床使用所需，信息审核过程中可对不符合申报企业要求的企业停止申报资格。

注意（2）输液器第1、2每个产品分组至多可申报同规格型号（相同规格不同针型（含无针），下同）一组产品；第3、4、6、7、8、9每个产品分组至多可申报同规格型号单头和双头两组产品；第5产品分组至多可申报同规格型号不含DEHP单头和双头、同规格型号含DEHP单头和双头四组产品。预充式导管冲洗器第10产品分组申报必须包含10ml产品。血液透析浓缩物第11至15产品分组和医用胶16至18产品分组可按注册证为单位申报或补充产品。所有申报企业均可按以上要求申报或补充产品，不影响中选规则。

注意（3）同产品分组同申报企业所申报产品只能申报一个价格；输液器第5产品分组同申报企业不含DEHP与含DEHP可申报不同价格，但价差不小于10%；医用胶第16产品分组同申报企业第Ⅱ类与第Ⅲ类可申报不同价格，但价差不小于10%。

6、所有产品价格填报完成后，点击“完成耗材申报”。

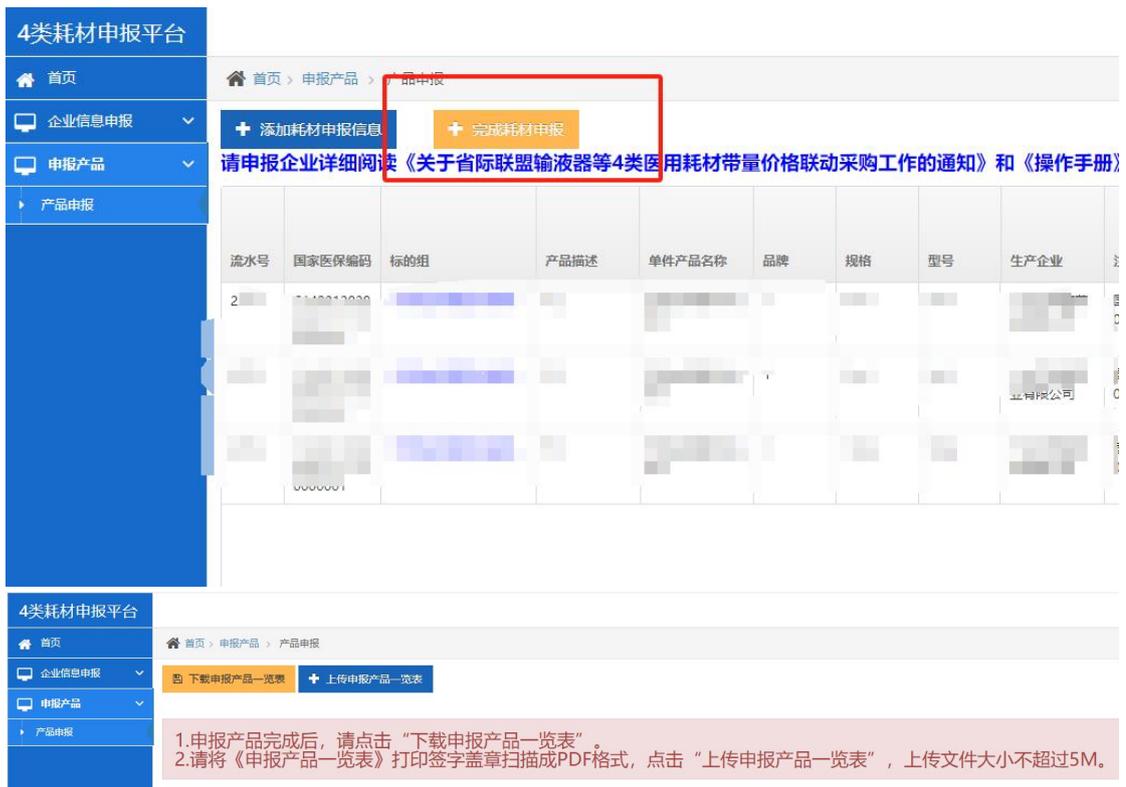


图 3.6 完成申报前界面

7、申报产品完成后，请点击“下载申报产品一览表”。请将《申报产品一览表》打印签字盖章扫描成 PDF 格式，点击“上传申报产品一览表”，上传文件大小不超过 5M。



图 3.7.1 上传申报产品一览表界面



图 3.7.2 上传完成后界面

四、注意事项

1、点击页面右上角，输入新旧密码，可完成密码修改功能。



图 4.1 修改密码界面

2、退出登录请点右上角“注销”，不要直接关闭浏览器，直接关闭浏览器后再次登录，可能会有 20 分钟左右的延迟，暂时无法登录。



图 4.2 退出登录